
SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

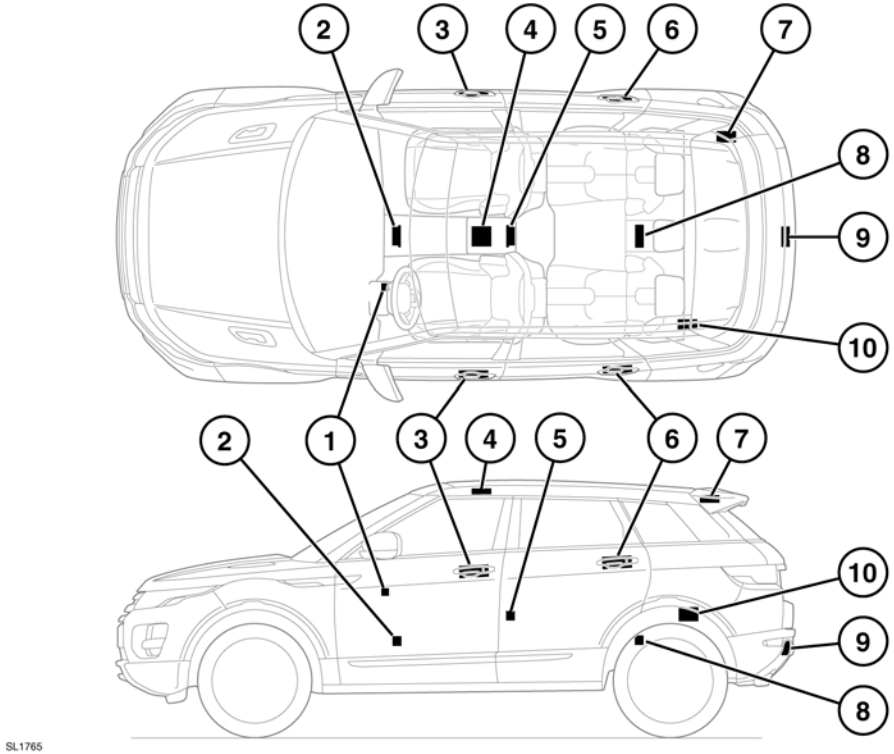

1. Lenksäulen-Hilfssender
2. Fahrersitzsender vorn
3. Türaußengriff-Sender vorn
4. Keyless-Dachempfänger
5. Bodenkonsolen-Sender vorn
6. Türaußengriff-Sender hinten
7. Laderaumsender
8. Bodenkonsolen-Sender hinten
9. Passive Entry-Heckklappenempfänger
10. Keyless Start-Steuergerät

Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.