


# Technische Spezifikationen

## SMART KEY-SENDERPOSITIONEN

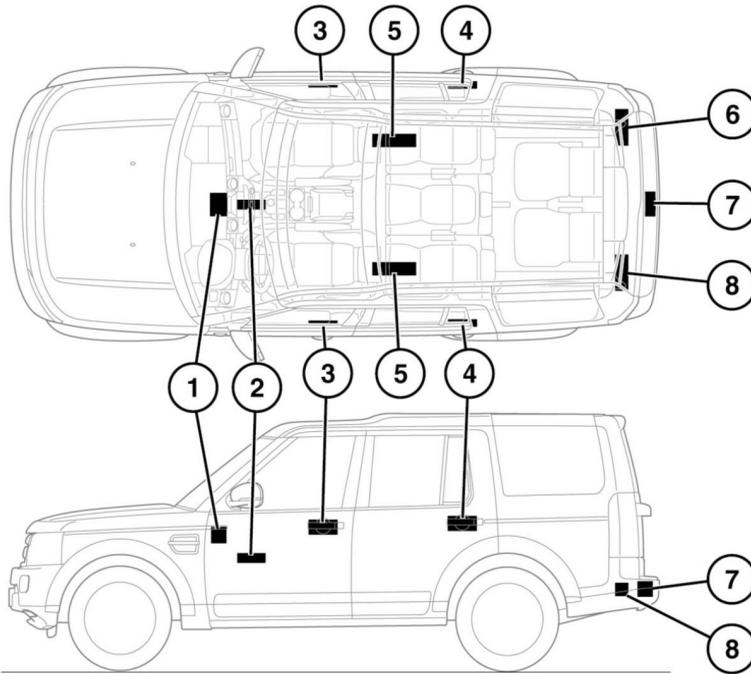

E155596

1. Sender vorn im Fahrgastraum.
2. Keyless Start-Steuergerät.
3. Türaußengriff-Sender vorn.
4. Türaußengriff-Sender hinten.
5. Dachhimmel-Sender.
6. Laderaum-Sender rechts.
7. Laderaumsender Mitte.
8. Laderaum-Sender links.



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.