


## 智能钥匙发射器位置

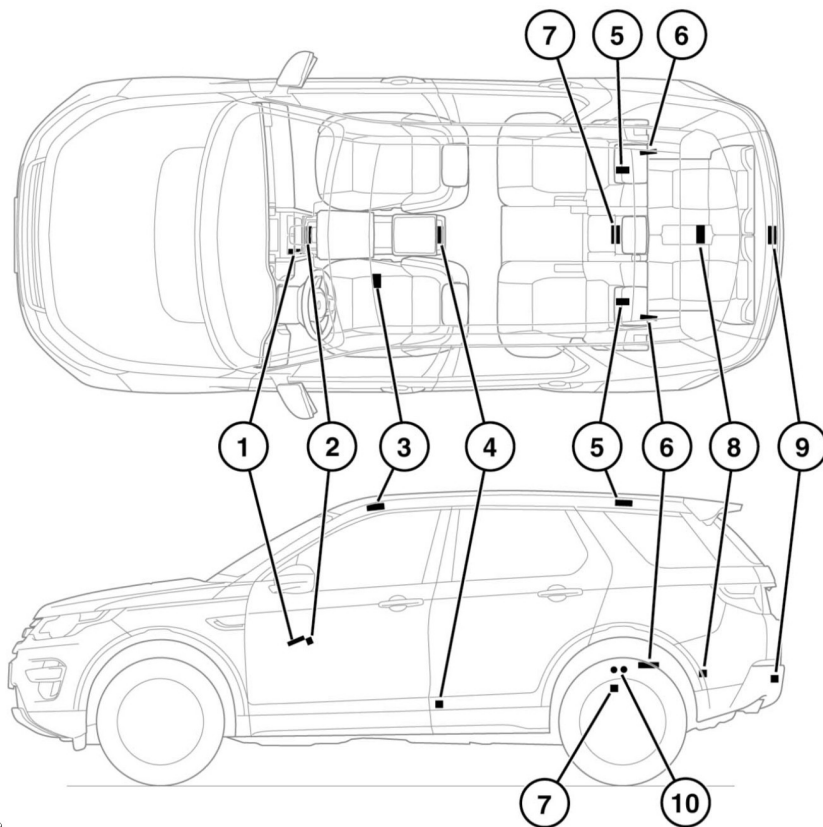

E164439

1. 中央控制台发射器。
2. 中央控制台发射器。
3. 车顶免钥接收器。
4. 中央控制台后部发射器。
5. 载货区发射器。
6. 地板控制台后部发射器（5座车辆）。
7. 地板控制台后部发射器（7座车辆）。
8. 地板控制台后部发射器（7座车辆）。
9. 尾门被动进入接收器。

### 10. 低频天线。



使用植入式医疗设备的任何人士都应该确保医疗设备距离车辆上安装的任何发射器至少 **22 厘米（8.7 英寸）**。这是为了避免系统与设备之间可能产生干扰。