


# 负荷承载

## 装载区域护罩



E150944

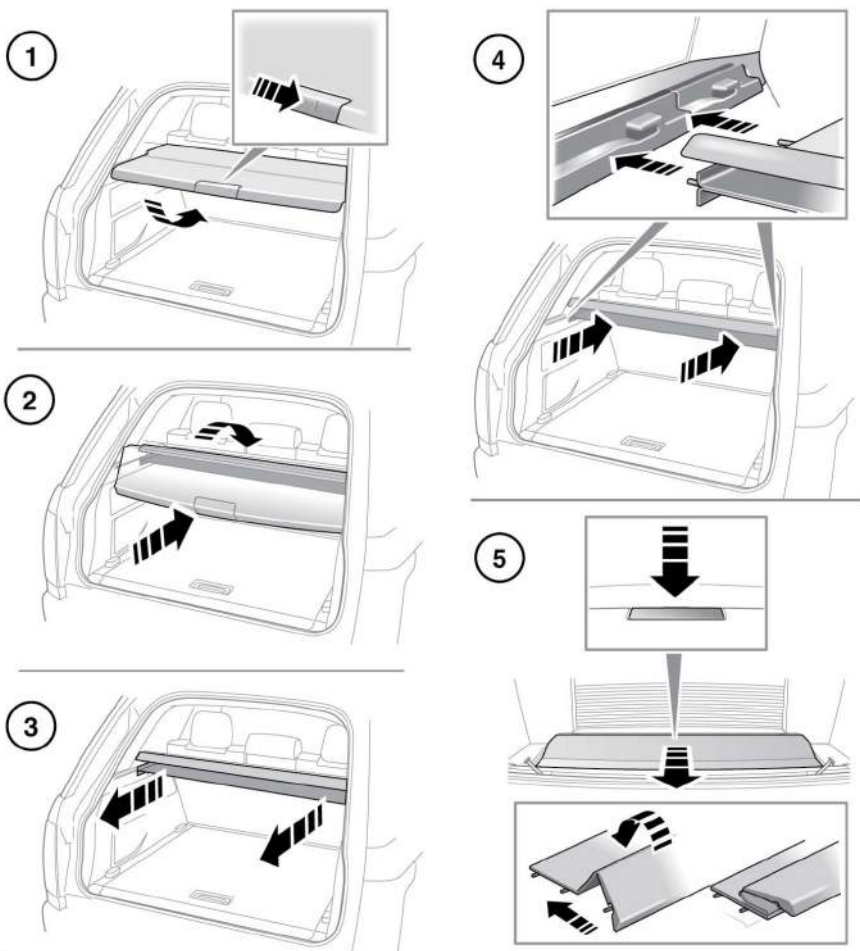

警告：医疗设备：前部和中间装载区护罩部分的下面各包含一个磁铁。磁铁位于车辆中线的下陷处。磁场可能会干扰起搏器、电震发生器或其他医疗设备。



当位于车内，或处理装载区护罩时，请在起搏器或电震发生器与载货区护罩之间维持至少 15 厘米（6 英寸）间隔。

警告：不要将装载区护罩松散地存放于车辆中。